TECNO

TECNO Watch GT

AI ON YOUR WRIST

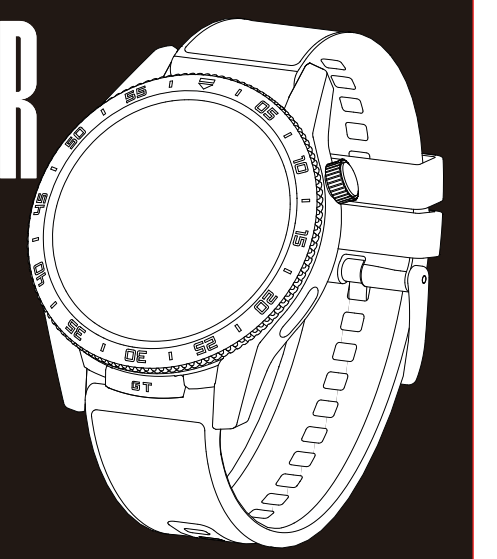

USER MANUAL
MODEL: WGT01

EN User Manual..01
RU Руководство пользовате.................14
ES Manual de usuario................................21
FR Manuel de l'utilisateur..........................29

Hereby,TECNO MOBILE LIMITED declares that this Smart Watch is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

CAUTION:

1. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type, dispose of used batteries according to the instructions.
– disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
– leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
– a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

2. EUT Temperature: 0℃ ~ +45℃(Standalone). 0℃~+40℃(with adapter).

Operating Frequency:

BT: 2400-2483.5MHz (TX/RX);

GNSS: 1559-1610MHz(RX)

Max. Of Transmit power:

BT(EDR): 4.67dBm
BLE: -1.54dBm

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.tecno-mobile.com/declaration/#/

FCC Caution:

Labeling requirements.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Note: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Welcome to use the smart watch, high-performance wrist strap smart watch to create a caring fitness experience for you.

Equipment maintenance

When taking care of your watch, keep the following tips in mind:
1. Clean the watch regularly, especially the inside of the watch, to keep it dry. Adjust the strap tightness to ensure air circulation.
2. The wrist worn on the watch should not use excessive skin care products.
3. If skin allergies or discomfort occur, please stop wearing.

Diagram mainframe of the watch

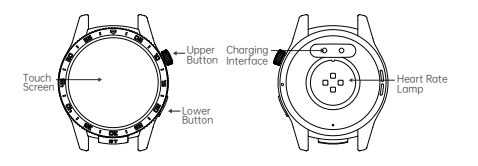

Boot up

Press and hold the side button for 3 seconds or plug in the charging cable to charge.

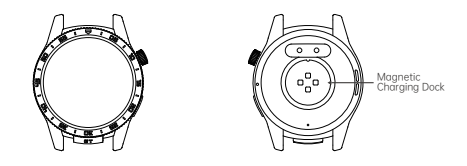

Download and install the APP:

(1) Use mobile phone to scan the QR code and download the APP.
(2) The iOS system selects the App store, searches for and downloads My Health, or scans the QR code to download.

The Android systems can choose Google Play to download and install My Health, or scan the QR code to download.

APP QR: My Health

Note: The phone must support Android 8.0 or iOS 12.0 system or above, Bluetooth version 4.0 or above。

*After first-time activation or factory reset, press & hold (3s) when QR code is displayed to revert to watch face.

2.How to Pair a Smartwatch and Download the APP

A. Method: Add Device B. Method: Scanning the watch QR code	A. Method: Click on your device in the list of scanned devices	Binding successful	How to Download the App
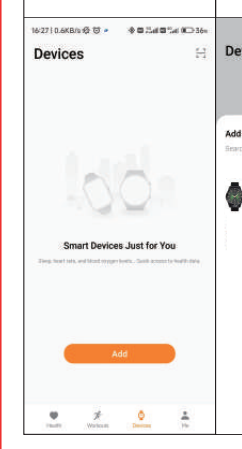	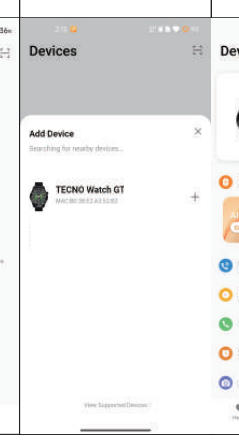	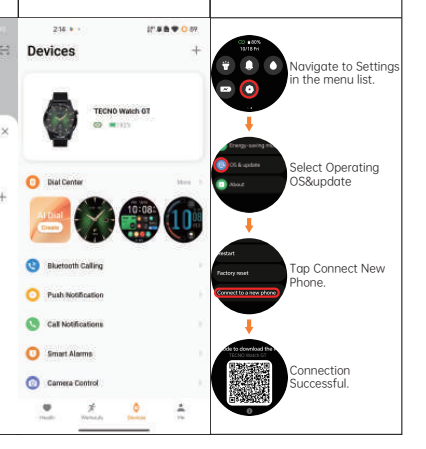	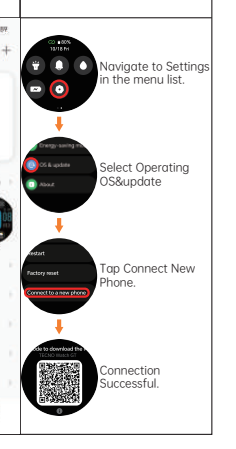 Navigate to Settings in the menu list. Select Operating OS&update Tap Connect New Phone. Connection Successful.

Phone Call Binding

① For Android Phones
After the APP is successfully bound, the phone will automatically pop up the select the Bluetooth 'TECNO Watch GT' pairing window, select 'Pair' option, as shown below:

② For iOS Mobile Phones
After the APP is successfully bound, the phone will automatically pop up the pairing window, select 'Pair' option, as shown below:

Android		iOS	
Pop up the select	Binding successful	Pop up the select	Binding successful
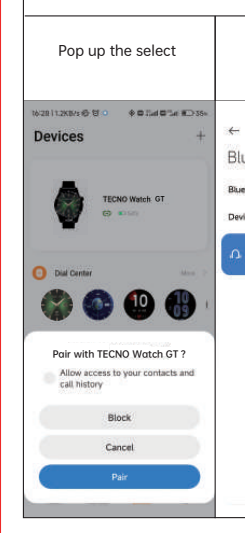	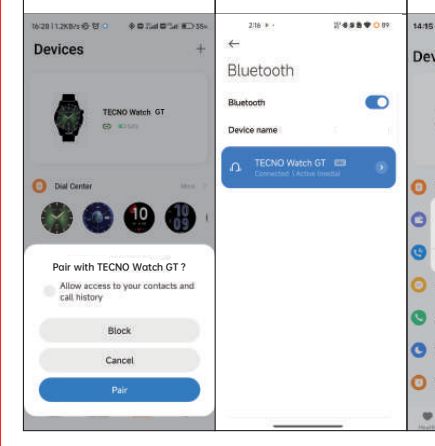	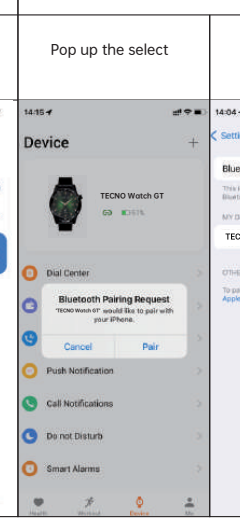	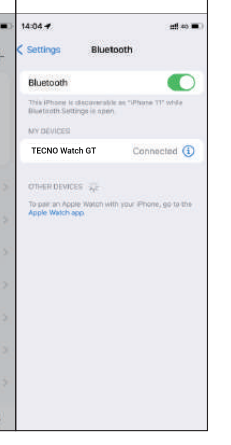

Watch function introduction

power on status:
Main screen menu interface switching, as shown below the interface, etc..

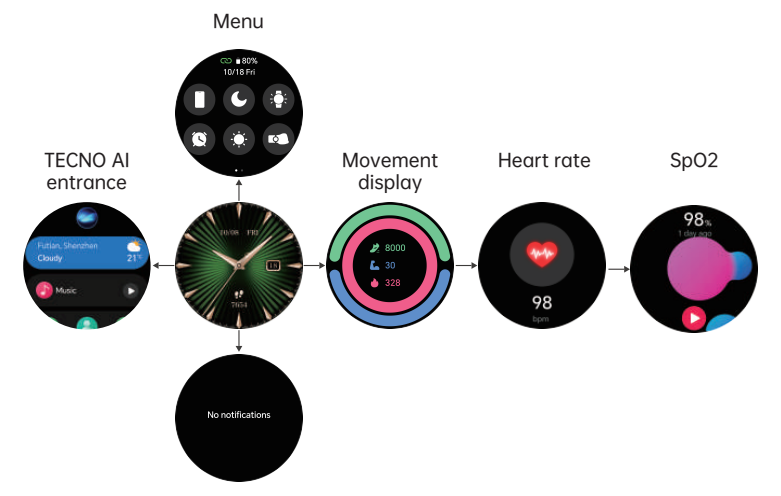

Replace AI dial

Connect your phone
First, connect to the phone's Bluetooth, open the My Health APP, and click on the center of the watch face in the order shown in the figure to create an AI watch face. Enter text to generate the watch face.

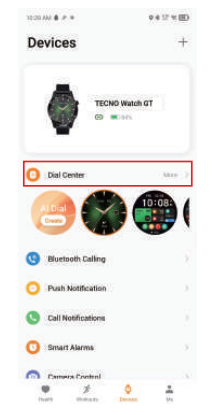

Dial center

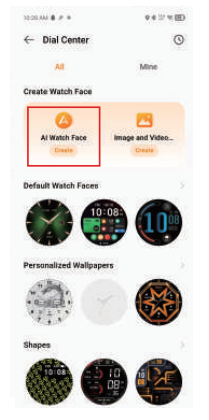

AI Creation

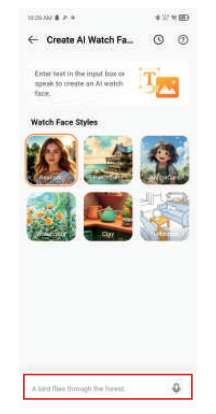

Enter text

Common problems

1.1 Make sure that the phone Bluetooth is turned on, and the watch is turned on;

1.2 When searching for Bluetooth, make sure that the watch has not been bound by other accounts;

1.3 When searching for Bluetooth, the watch and the phone should be as close as possible.

2. If the user has installed other software such as mobile phone housekeeper in the mobile phone, in order to ensure the normal operation of the background APP, please open the message push and allow the background running permission on the mobile phone, otherwise the message cannot be pushed.

3. Charging requirements:
Use a charger with a specification of 5V 0.5~1A to charge. If you do not use it for a long time, please be sure to turn off the system and keep the power supply once every month.

Disclaimer

Warning: This product is not a medical device, watch and its application should not be used to diagnose, treat or prevent diseases. If you want to change your exercise, sleep and other habits, please be sure to consult a qualified medical professional first to avoid serious casualties. The Company reserves the right to modify and improve any of the functions described in this manual without prior notice, and the Company reserves the right to continuously update the product content, and all content shall be subject to physical objects.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with
Annex VI of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council

1.For the following Radio equipment:
Model: WGT01
Product: Smart Watch
Trade name or Brand: TECNO
Software / Hardware number: V1.0/WGT01-S1-V1.0

2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative:
Manufacturer:TECNO MOBILE LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer.

4. Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment):

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU (RED)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Article 3.1a Health:
EN 62479:2010
EN 50663:2017

Article 3.1a Electrical Safety:
EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020

Article 3.1b:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)

Article 3.2:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)

7.Notified Body Name: WORLD STANDARDIZATION CERTIFICATION & TESTING POLSKA Sp. z o.o.
Notified Body Number: 2618
Notified Body Assessment Performed: Module B/C on Article 3.1a, 3.1b and 3.2
Technical File Identification Number: N/A

8.Where applicable, description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity: User instructions are provided in the User Manual. The Software and Hardware versions are specified above.

9.Additional information:
Referring to Article 10.2 of the Directive, this equipment is so constructed that it can be operated in all Member States, without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.
Referring to Article 10.10 of the Directive, there are no restrictions on putting this equipment into service or of requirements for authorization of use. Please refer to the User Manual for details.

On behalf of:

Manufacturer: TECNO MOBILE LIMITED
Address: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

(place and date of issue): Shenzhen, 2025-05-14

(name, function): YangDaozhuang/ Manager

(signature): YangDaozhuang

(Name and signature of person responsible)

CUSTOMER SERVICE

Name:	
Address:	
Tel.No:	
Date of purchase: (dd/mm/aa)	
S/N:	

TECNO MOBILE LIMITED

TM and Copyright ©2010-2025 TECNO Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned here in may be trade marks or trade names of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Model names and the availability of particular products may vary by region.

www.tecno-mobile.com
service.us@tecno-mobile.com

More Products

Multiple Language

Добро пожаловать в мир умных часов! Высокопроизводительный умный браслет создан для того, чтобы обеспечить вам заботливый фитнес-опыт.

Уход за устройством

При обслуживании часов соблюдайте следующие рекомендации:
1. Регулярная очистка, Протирайте корпус часов, особенно внутреннюю часть, чтобы сохранять их сухими.Отрегулируйте плотность ремешка для обеспечения циркуляции воздуха.
2. Использование косметических средств, Не наносите чрезмерное количество кремов или лосьонов на запястье, где носите часы.
3. При возникновении аллергии или дискомфорта прекратите использование.

Схема устройства часов

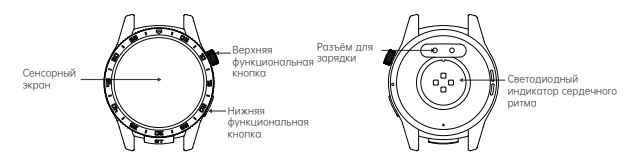
Сенсорный экран
Верхняя функциональная кнопка
Нижняя функциональная кнопка
Разъём для зарядки
Светодиодный индикатор сердечного ритма

Включение

Нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 3 секунд, Или подключите зарядный кабель для активации зарядки.

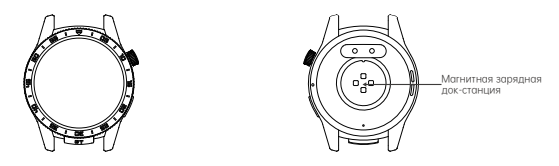

Скачайте и установите приложение:

(1) Используйте мобильный телефон, чтобы отсканировать QR-код и скачать приложение.
(2) Для iOS: выберите App Store, найдите приложение 'My Health' и установите его или отсканируйте QR-код для загрузки.

Для Android: выберите Google Play, найдите приложение 'My Health' и установите его или отсканируйте QR-код для загрузки.

APP QR: My Health

Примечание: Телефон должен поддерживать систему Android 8.0 или выше, iOS 12.0 или выше, а также версию Bluetooth 4.0 или выше.

*После первоначальной активации или сброса к заводским настройкам, нажмите и удерживайте (3 секунды) на экране при отображении QR-кода, чтобы вернуться на главный экран часов.

2.Как подключить умные часы и скачать приложение

А. Метод: Добавить устройство В. Метод: Сканирование QR-кода часов	А. Метод: Нажмите на ваше устройство в списке обнаруженных устройств.	Привязка успешно	Как скачать приложение
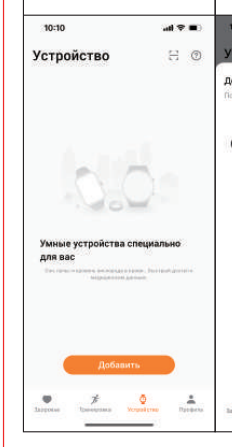	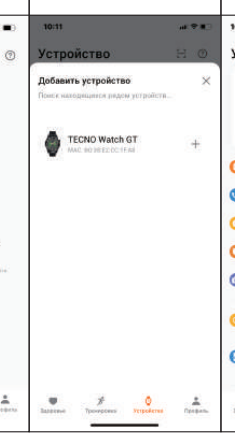	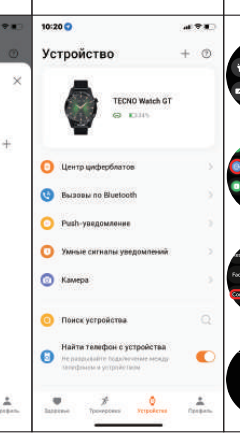	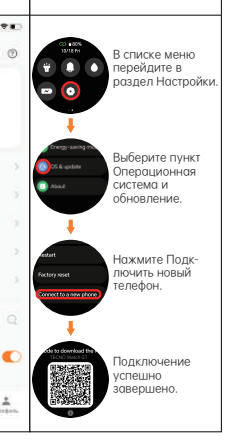 В списке меню перейдите в раздел Настройки. Выберите пункт Операционная система и обновление. Нажмите Подключить новый телефон. Подключение успешно завершено.

Телефонный звонок Привязка

1. Для телефонов на Android
После успешной привязки приложения, телефон автоматически отобразит окно выбора Bluetooth 'TECNO Watch GT' для пары, выберите опцию 'Pair', как показано ниже:

2.Для мобильных телефонов на iOS
После успешной привязки приложения, телефон автоматически отобразит окно пары, выберите опцию 'Pair', как показано ниже:

Android		iOS	
Всплывающее окно выбора	Привязка успешно	Всплывающее окно выбора	Привязка успешно
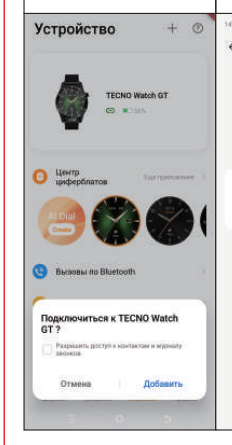	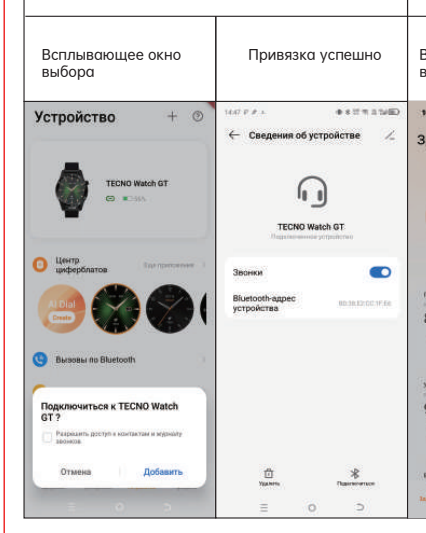	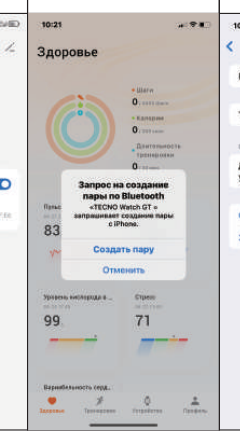	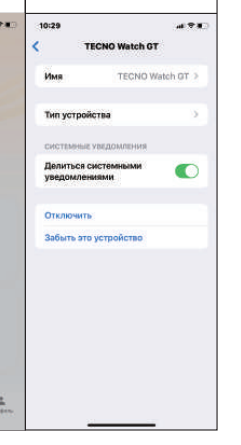

Описание функций часов

Состояние включения:
Переключение интерфейса меню на главном экране, как показано ниже на интерфейсе и т.д.

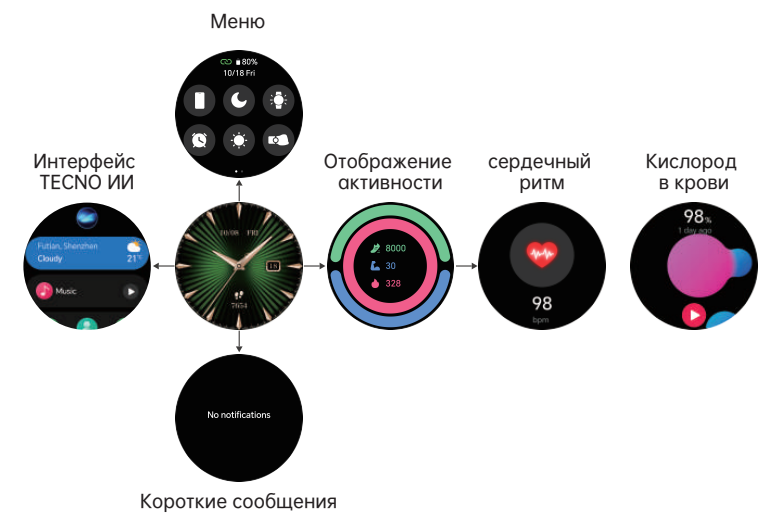

Замена циферблата AI

Подключите свой телефон
Сначала подключитесь к Bluetooth телефона, откройте приложение My Health и нажмите на центр циферблата в порядке, показанном на рисунке, чтобы создать циферблат AI. Введите текст для создания циферблата.

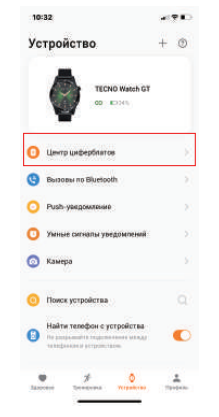

Центр циферблата

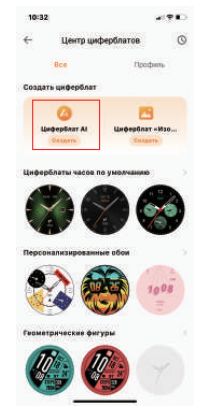

Создание AI

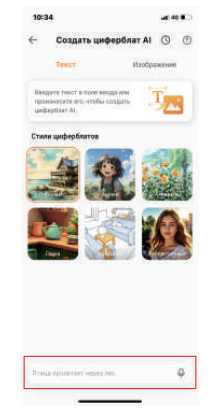

Введите текст

Включение

Технические характеристики
Изделие: Смарт-часы
Модель: WGT01
Тип батареи: Литий-ионный полимерный аккумулятор
Емкость батареи: 480 мА·ч
Интерфейс зарядного устройства: Зарядка с магнитным притяжением
Рабочая температура: от 0 °C до 43 °C
Материал браслета: Силикон
Диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц
Беспроводное подключение: Bluetooth 5.3
Степень водонепроницаемости 3ATM
Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования
Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования, следует утилизировать отдельно от не сортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.
Соответствие техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
1) Дата изготовления: см. на упаковке
2) Страна-изготовитель: Китай
3) Подробную информацию об импортере и контакты отдела послепродажного обслуживания смотри на упаковке.
4) Срок службы: Установленный производителем срок службы изделия равен 2 годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.
5) Температура хранения — от –10 °C до 45 °C, Влажность при хранении 30–75%.

Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте включить его снова.
Правила и условия реализации: без ограничений. Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт сдавливанию или ударам во время транспортировки.

Продукция соответствует ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Сервисный центр

Горячая линия: 8-800-707-06-55
Список авторизованных сервисных центров может быть изменен без отдельного уведомления.
Актуальный список авторизованных СЦ можно найти на интернет сайте: https://www.carlcare.com/ru/ или использовав QR код

Больше продуктов

Множество языков

Bienvenido a utilizar el smartwatch de alta performance, un smartwatch con correa de muñeca diseñado para crear una experiencia de fitness cuidadosa para ti

Mantenimiento de equipos

When taking care of your watch, keep the following tips in mind
1. Limpia el reloj regularmente, especialmente el interior del reloj, para mantenerlo seco. Ajusta la tensión de la correa para garantizar la circulación de aire.
2. No apliques una cantidad excesiva de productos de cuidado de la piel en la muñeca donde llevas el reloj.
3.Si ocurren alergias cutáneas o malestar, por favor deja de usarlo.

Diagrama del chasis principal del reloj

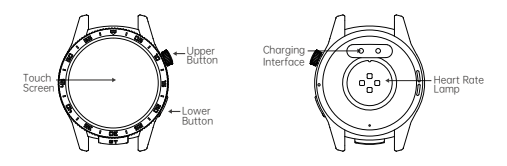

Encendido

Mantén pulsado el botón lateral durante 3 segundos o conecta el cable de carga para iniciar la carga.

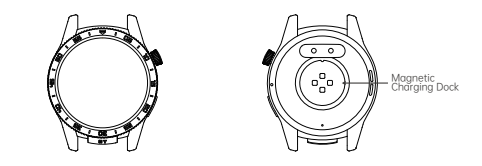

Descarga e instala la aplicación:

(1) Utiliza el teléfono móvil para escanear el código QR y descargar la aplicación.
(2) El sistema iOS selecciona la App Store, busca y descarga My Health, o escanea el código QR para descargar.

Los sistemas Android pueden elegir Google Play para descargar e instalar My Health, o escanear el código QR para descargar.

APP QR: My Health

Nota: El teléfono debe admitir sistema Android 8.0 o iOS 12.0 o superior, y versión Bluetooth 4.0 o superior.

* Después de la activación inicial o el restablecimiento de fábrica, presione y mantenga (3 segundos) cuando se muestre el código QR para volver a la pantalla principal del reloj.

2.Cómo emparejar un reloj inteligente y descargar la app

A. Método: Agregar dispositivo. B. Método: Escanear el código QR del reloj	A. Método: Hacer clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados	Vinculación exitosa	Cómo descargar la aplicación.
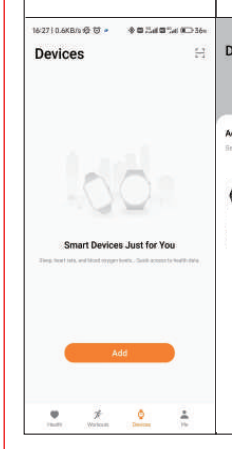	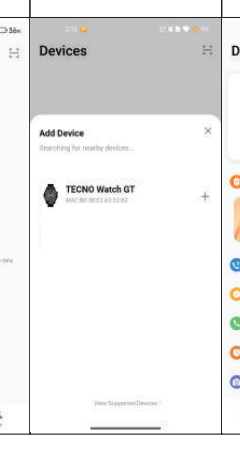	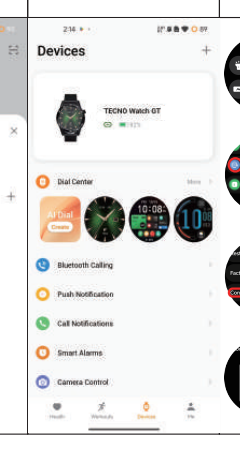	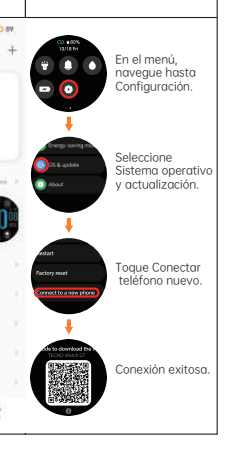 En el menú, navegue hasta Configuración. Seleccione Sistema operativo y actualización. Toque Conectar teléfono nuevo. Conexión exitosa.

Vinculación de llamadas Telefónicas

1. Para teléfonos Android
Después de vincular la aplicación correctamente, el teléfono mostrará automáticamente la ventana de selección del emparejamiento Bluetooth 'TECNO Watch GT '. Seleccione la opción 'Pair', como se muestra a continuación:

1. Para teléfonos móviles iOS
Después de vincular la aplicación correctamente, el teléfono mostrará automáticamente la ventana de emparejamiento. Seleccione la opción 'Pair', como se muestra a continuación:

Android		iOS	
Aparecerá la ventana de selección	vinculación exitosa	Aparecerá la ventana de selección	vinculación exitosa
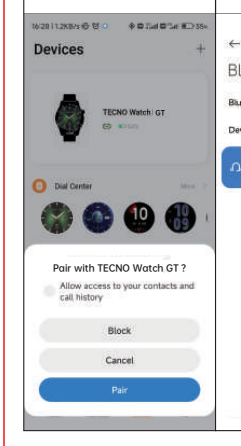	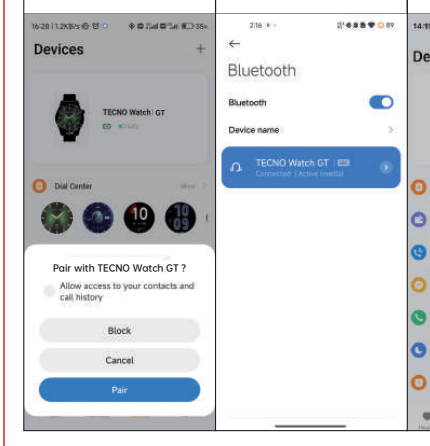	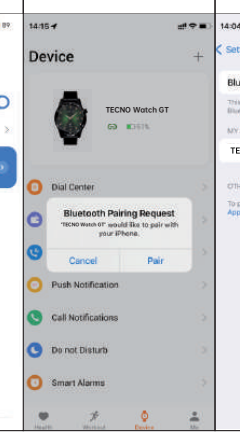	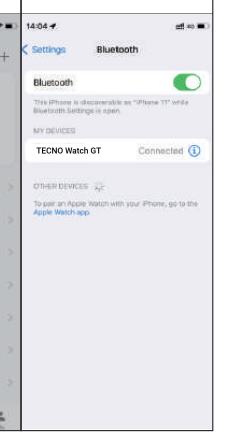

Introducción de las funciones del reloj

Estado de encendido:
Cambio de interfaz del menú principal, como se muestra en la imagen a continuación, etc.

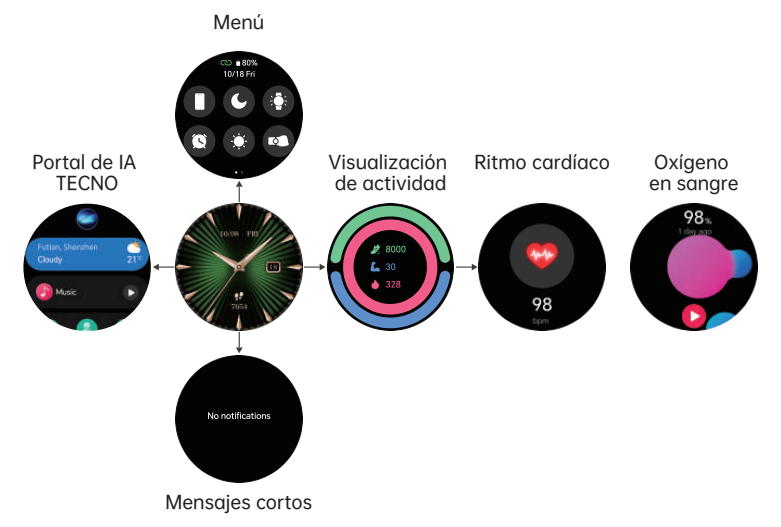

Esfera personalizable con IA

Conectar tu teléfono
Primero, conecta al Bluetooth del teléfono, abre la aplicación My Health y haz clic en el centro de la esfera del reloj en el orden que se muestra en la figura para crear una esfera de IA. Ingresa texto para generar la esfera del reloj.

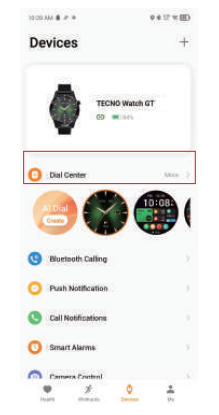

Centro de la esfera

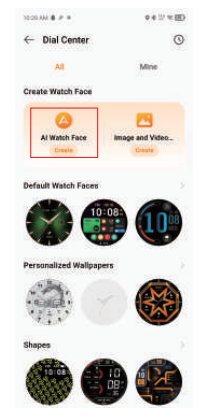

Creación con IA

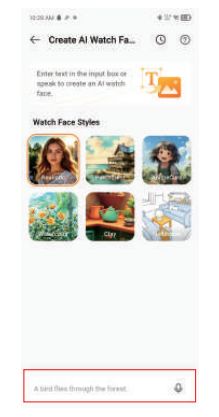

Ingresar texto

Más productos

Múltiples idiomas

Bienvenue dans l'utilisation de la montre intelligente, équipée d'un bracelet haute performance.La montre intelligente crée pour vous une expérience de fitness bienveillante.

Maintenance de l'appareil

Lorsque vous prenez soin de votre montre, gardez à l'esprit les conseils suivants:
1. Nettoyage régulier, Nettoyez régulièrement la montre, en particulier l'intérieur du boîtier, afin de maintenir sa sécheresse.Ajustez la tension du bracelet pour assurer une circulation d'air optimale.
2. Précautions d'utilisation, Évitez d'appliquer une quantité excessive de produits cosmétiques sur le poignet où est portée la montre.
3. Confort et sécurité, En cas d'allergies cutanées ou d'inconfort, retirez immédiatement la montre et consultez un professionnel de santé.

Schéma technique du boîtier de la montre

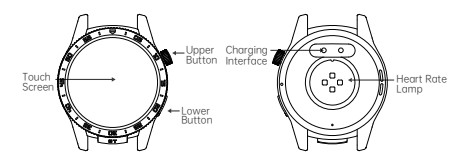

Démarrage de l'appareil

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral pendant 3 secondes ou branchez le chargeur pour activer la montre.

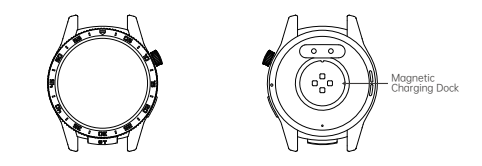

Téléchargement et installation de l'application :

(1) Utilisez un téléphone portable pour scanner le code QR et télécharger l'application.
(2) Pour les systèmes iOS: sélectionnez l'App Store, recherchez et téléchargez My Health, ou scannez le code QR pour le télécharger.
Pour les systèmes Android: choisissez Google Play pour télécharger et installer My Health, ou scannez le code QR pour le télécharger.

APP QR : My Health

Le téléphone doit être compatible avec les systèmes Android 8.0 ou iOS 12.0 (ou versions ultérieures), ainsi que la version Bluetooth 4.0 ou supérieure.

*Après l'activation initiale ou la réinitialisation d'usine, appuyez et maintenez (3 secondes) lorsque le code QR est affiché pour revenir au cadran de la montre.

2.Comment associer une montre connectée et télécharger l'application

A. Méthode : Ajouter un appareil B.Méthode : Scanner le code QR de la montre	A. Méthode : Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils scannés	Association réussie	Comment télécharger l'application
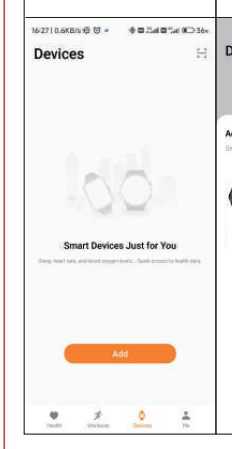	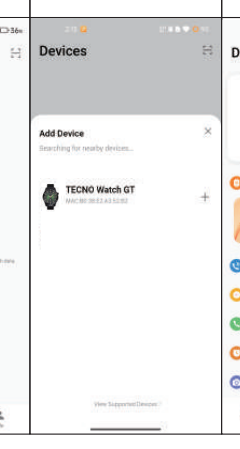	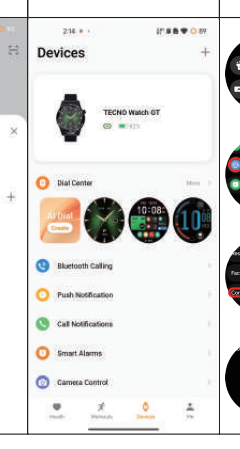	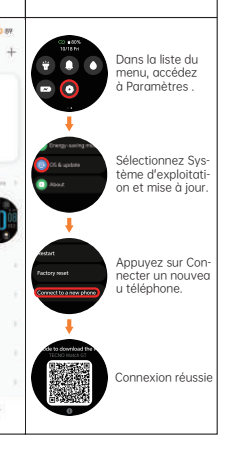 Dans la liste du menu, accédez à Paramètres . Sélectionnez Système d'exploitation et mise à jour. Appuyez sur Connecter un nouveau téléphone. Connexion réussie

Pour les téléphones Android

① Une fois l'application correctement associée, le téléphone affichera automatiquement une fenêtre de sélection pour l'appairage Bluetooth'TECNO Watch GT'. Sélectionnez l'option 'pairer', comme illustré ci-dessous :

② Pour les appareils iOS
Une fois l'application correctement associée, le téléphone affichera automatiquement une fenêtre d'appairage Bluetooth. Sélectionnez l'option pair , comme illustré ci-dessous:

Android		iOS	
Fenêtre de sélection apparaîtra	Liaison réussie	Fenêtre de sélection apparaîtra	Liaison réussie
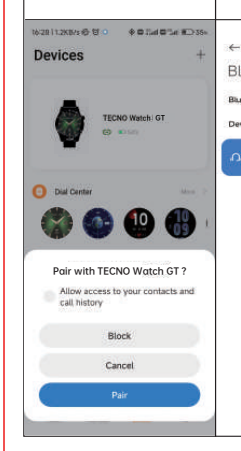	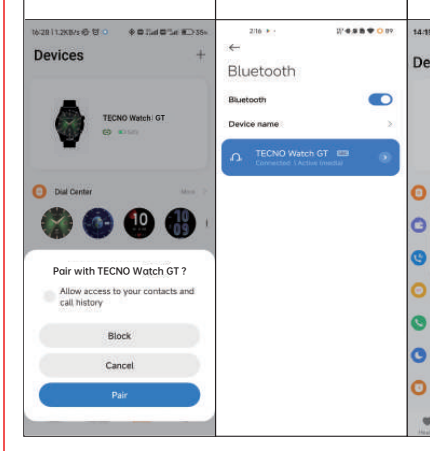	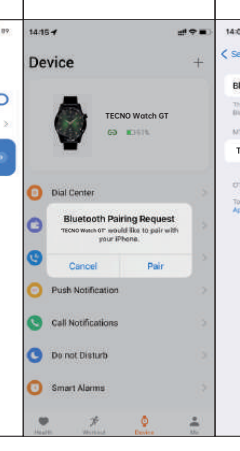	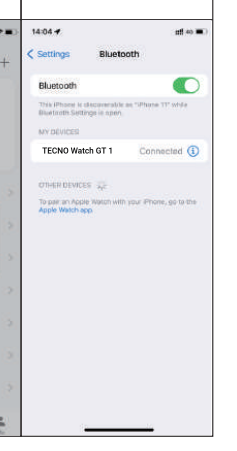

Présentation des fonctions de la montre

État de fonctionnement (sous tension) :
Navigation entre les interfaces du menu principal : Basculer entre les écrans du menu, comme illustré dans les exemples d'interface ci-dessous.

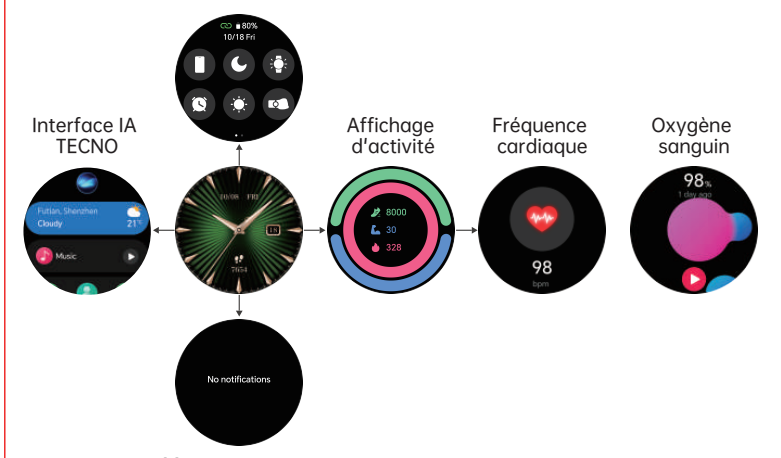

Remplacement du cadran IA

Connectez votre montre au Bluetooth du téléphone
Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé, Ouvrez l'application My Health sur votre téléphone.Création d'un cadran IA personnalisé, Appuyez sur le centre du cadran de la montre, comme indiqué dans l'illustration.Saisissez un texte pour générer un cadran personnalisé basé sur l'IA.

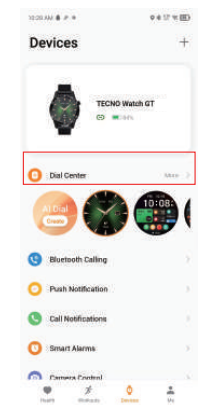

Centre du cadran

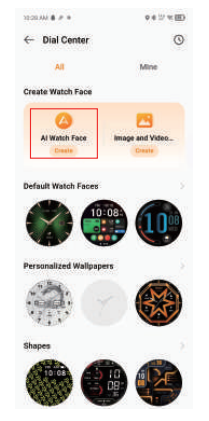

Création par IA

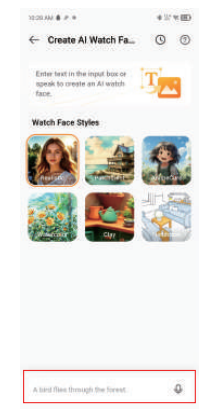

Saisir le texte

Plus de produits

Multilingue