


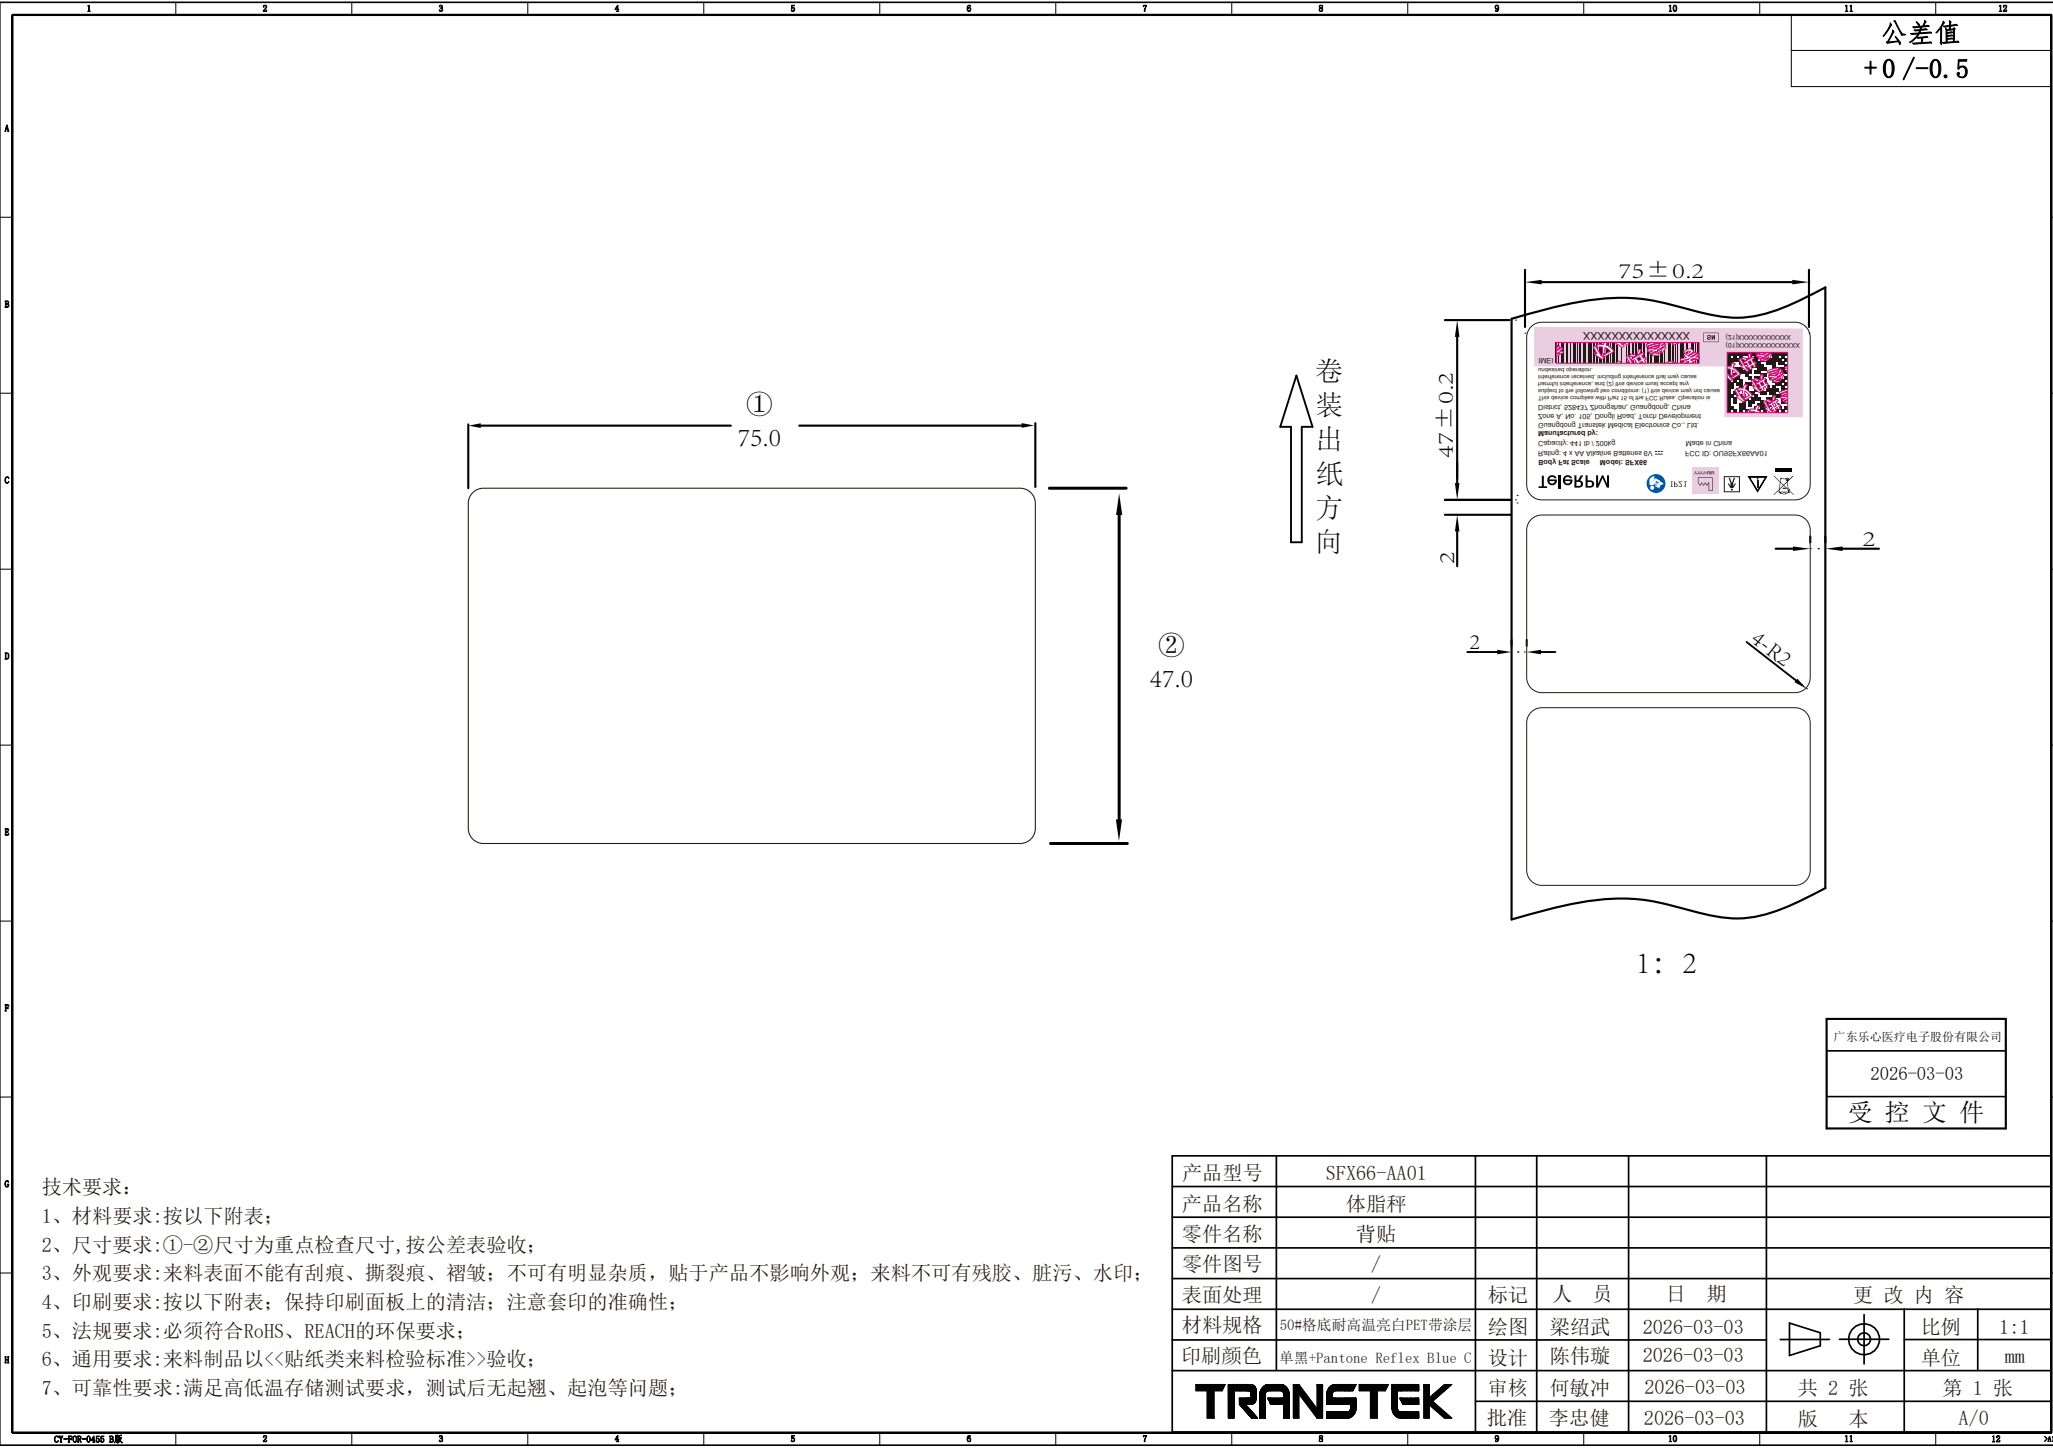

公差值
+0/-0.5

卷装
出纸方向

1: 2

广东乐心医疗电子股份有限公司
2026-03-03
受 控 文 件

- 技术要求:
- 1、材料要求:按以下附表;
 - 2、尺寸要求:①-②尺寸为重点检查尺寸,按公差表验收;
 - 3、外观要求:来料表面不能有刮痕、撕裂痕、褶皱;不可有明显杂质,贴于产品不影响外观;来料不可有残胶、脏污、水印;
 - 4、印刷要求:按以下附表;保持印刷面板上的清洁;注意套印的准确性;
 - 5、法规要求:必须符合RoHS、REACH的环保要求;
 - 6、通用要求:来料制品以<<贴纸类来料检验标准>>验收;
 - 7、可靠性要求:满足高低温存储测试要求,测试后无起翘、起泡等问题;

产品型号	SFX66-AA01				
产品名称	体脂秤				
零件名称	背贴				
零件图号	/				
表面处理	/	标记	人 员	日 期	更 改 内 容
材料规格	50#格底耐高温亮白PET带涂层	绘图	梁绍武	2026-03-03	  比例1:1
印刷颜色	单黑+Pantone Reflex Blue C	设计	陈伟璇	2026-03-03	
TRANSTEK	审核	何敏冲	2026-03-03	共 2 张	第 1 张
	批准	李忠健	2026-03-03	版 本	A/0



Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.
广东乐心医疗电子股份有限公司


Document Name: 文件名称:	LABEL
Document No 文件编号:	LS-LABEL-SFX66-02
Rev.: 版本号:	A/0
Page: 页码:	Total 2 pages

Prepared 编制	Reviewed 审核	Approved 批准
Coco Chen	Aimee Li	Rachel

◆ Revision History 修订履历

NO.	Date 日期	Update Description 变更描述	Prepared 编制	Reviewed 审核	Approved 批准
A/0	2026/03/03	Initial release	陈伟璇 Coco Chen	黎萍芳 Aimee Li	胡丽琼 Rachel Hu

SFX66- (FDA) LABEL
SIZE: 75 * 47 mm

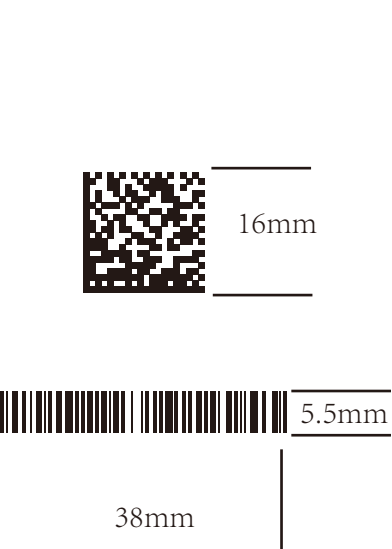


UDI (GS1 Datamatrix 二维码格式)
(此二维码尺寸设计为11*11mm, 条码扫描等级要求能达到最低等级C) (注意条码读取出来的数值不含括号())
UDI=DI+PI, 此UDI二维码就是由DI+PI两组数据生成的。
DI由标识符(01)+后面的14位数字组成, 是唯一的。内部打印出来的贴纸必须跟 (01) 后面14位数字进行核对, 保持一致!
PI由标识符(21)+后面的12位数值组成 (也即流水号, 编码规则详见流水号编码规则),
其中第1位数字“2”代表电子秤, 第2、3位数值是客户ID, 内部打印出来的贴纸必须跟 (21) 后面的前3位数值进行核对, 保持一致!
从第4位开始分别是生产年份, 生产周数, 流水编号, 跟制造日期 YYYY-MM 一样, 是跟实际生产的年月, 生产数量相关, 请以是实际为准。

IMEI code (it come from the communication module on the device)
是模块上的IMEI号, 生产的时候, 产线用扫描枪扫描通讯模块屏蔽罩表面的二维码可以识别出IMEI号


说明 / Illustrate :
整个背贴在乐心 MES系统上生成并打印, 其中UDI (GS1 datamatrix 二维码) 由下述2组数据组成
The whole label is generated and printed by MES system of Transtek. UDI (GS1 datamatrix barcode) is generated by the two data below.

- (01) 00810079250042----> 代表UDI的DI信息, 客户的每一款产品都是唯一的, 由GS1 DI标识符“(01)” + 14位数字的“DI” 组成
(21) 252250900001-----> 流水号, 代表UDI的PI信息, 由流水号标识符 “(21)” +12位的流水号组成, 12位流水号的编码规则如下
(01) 00810079250042----> Stand for the "Device Identifier (DI) Information" of UDI, it is unique for each product of the customer. it is consist of GS1 DI Identifier“(01)” and 14-digit (DI) .
(21) 252250900001-----> Serial number, stand for the PI information of UDI, consist of GS1 SN Identifier“(21)” and 12-bit "SN datas" , the coding rules of the 12-bit SN as below.

流水号是以12位数值构成, 表示如下:
The serial numbers is consist of 12-bit datas.

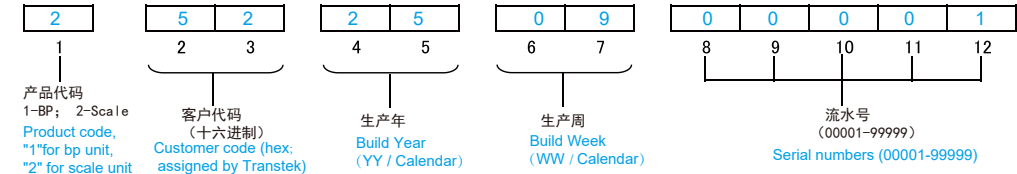

比如框中的 “252250900001” 代表Transtek为客户代码为00的客户在2020年第23周生产的第1台电子秤产品, 对应的流水号为 “00001” 。
For the data “252250900001” in the above frame , it means this is a SCALE product of the customer with Transtek assigned product code “00”. It is produced on the 23th week of year 2020 and its serial number is “00001”.

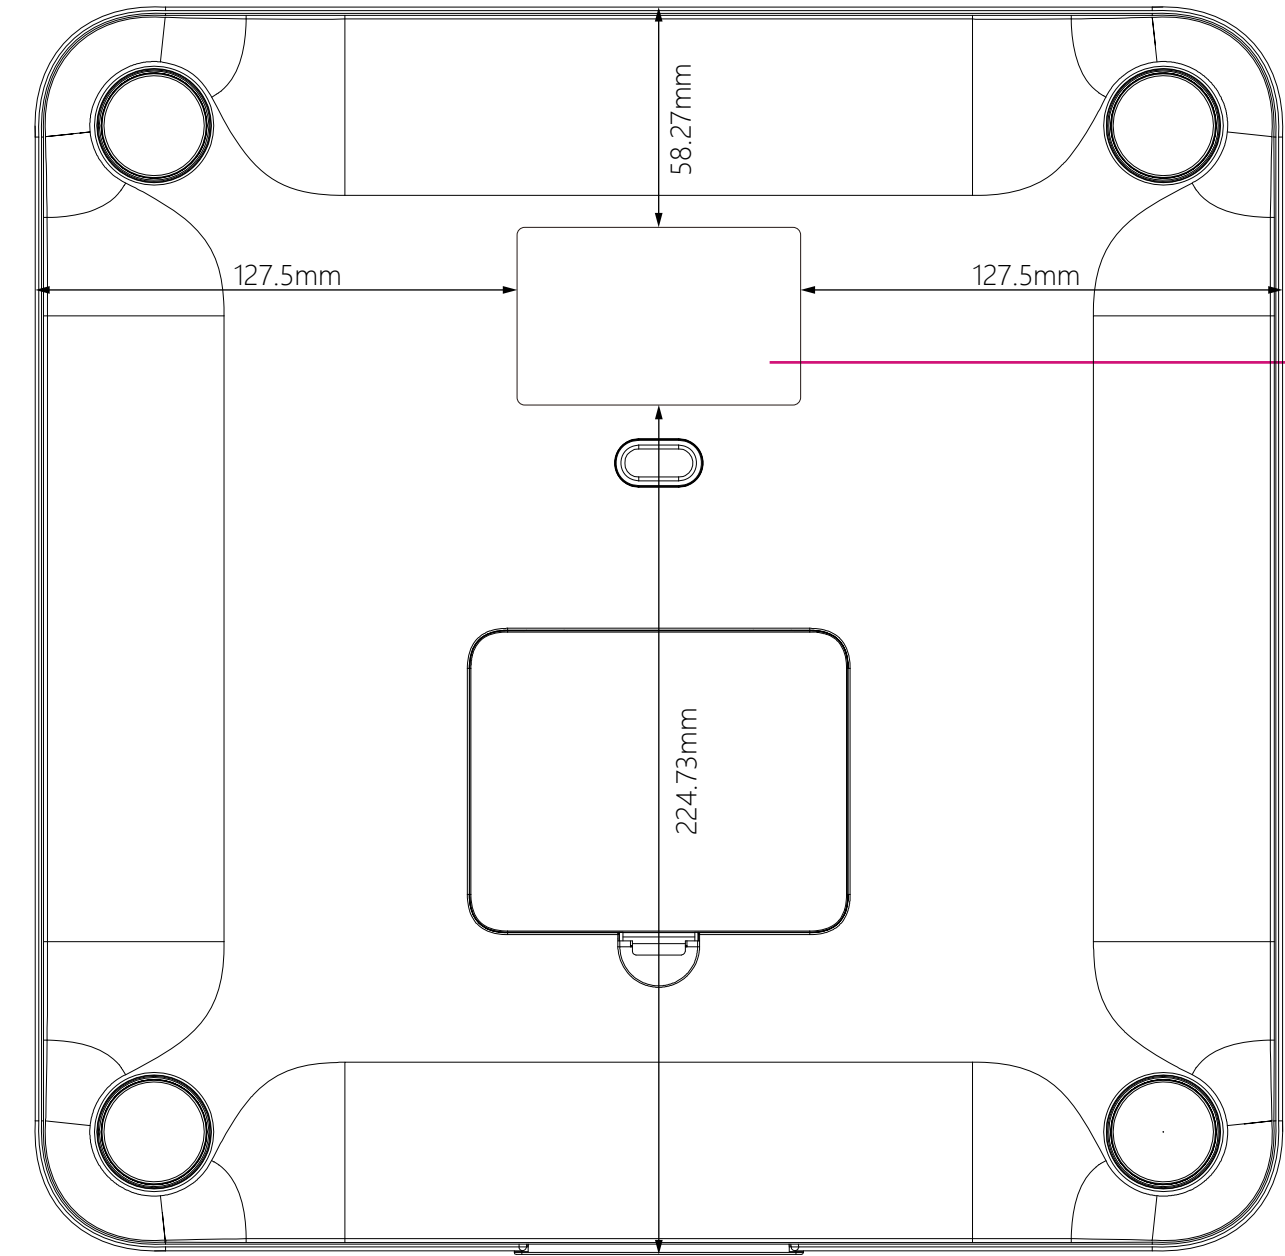

LOCATION

卷装
出纸方向

